ЦИФРОВИЙ РЕФРАКТОР

PDR-7000

Специфікація

Сфера (SPH)	Діапазон вимірювань	-29.00 ~ +26.75D (загальний)
		-19.00 ~ +16.75D (перехресний циліндр або призма)
	Кроки вимірювань	0.12D/0.25D/0.50D/1.00D
Циліндр (CYL)	Діапазон вимірювань	0.00 ~ ±8.75D
	Кроки вимірювань	0.25D/1D/2D/3D
Вісь (AX)	Діапазон вимірювань	0° ~ 180°
	Кроки вимірювань	1°/5°/15°
Міжзінична відстань (PD)	Діапазон вимірювань	48 ~ 80 мм
	Відстань вимірювання	35 ~ 70 см
	Кроки вимірювань	0.5 мм/1.0 мм
Рівень призм	Діапазон вимірювань	0Δ ~ 20Δ
	Кроки вимірювань	0.1Δ/0.5Δ/2Δ
Кут призм	Діапазон вимірювань	0° ~ 360°
	Кроки вимірювань	1°/5°
Перехресний циліндр	Автоматичний перехресний циліндр ± 0.25D	
	0.25D ± перехресний циліндр	
	0.50D ± перехресний циліндр	
Допоміжні лінзи	P.D/оклюдер/ оклюдер з отвіром (Ø2мм)/ поляризований світлофільтр45°/135°)	
	Напрямні Меддокса (праве око: горизонтальний; ліве око: вертикальний)	
	Червоно-зелений фільтр (праве око: червоний фільтр; ліве око: зелений фільтр)	
	Поляризований світлофільтр (праве око: 135°, 45°; ліве око: 45°, 135°)	
	Поділ призм (праве око: 6Δ BU; ліве око: 10Δ BU)	

АВТОМАТИЧНИЙ РЕФРАКТО/КЕРАТОМЕТР

PRK-6000

Специфікація

РЕЖИМИ ВИМІРЮВАННЯ	
РЕЖИМ K/R	Поєднані Кератометрія та Рефрактометрія
РЕЖИМ REF	Рефрактометрія
РЕЖИМ KER	Кератометрія
РЕЖИМ CLBC	Режим вимірювання базової кривизни контактних лінз
РЕЖИМ K(P)	Периферійна кератометрія
РЕФРАКТОМЕТРІЯ	
Вертексна відстань(VD)	0.0, 12.0, 13.5
Ось(SPH)	-25.00 ~ +22.00D (при VD=12мм) (з кроком: 0.12 і 0.25D)
Циліндр (CYL)	0.00 ~ ±10.00D (з кроком: 0.12 і 0.25D)
Ось (AX)	1 ~ 180° (з кроком : 1°)
Види циліндрів	-, +, MIX
Міжзінична відстань (PD)	10 ~ 85мм
Мінімальний діаметр зіниці	Ø2.0мм
КЕРАТОМЕТРІЯ	
Радіус кривизни	5.0 ~ 10.2мм (з кроком : 0.01мм)
Рогівкова рефракція	33.00 ~ 67.50 D (при еквівалентному показнику заломлення рогівки 1.3375) (з кроком: 0.05/0.12/0.25 D)
Рогівковий астигматизм	0.00 ~ -15.00D (з кроком : 0.05/0.12/0.25D)
Ось	1 ~ 180° (з кроком : 1°)
ІНШІ	
Corneal Diameter	2.0 ~ 12.0мм (з кроком : 0.1мм)
Пам'ять даних	10 вимірювань на кожне око
Вбудований принтер	Стрічковий термопринтер з автовідрізом
Монітор	16.25 см(6.4 дюйм) TFT-LCD (640 × 480 , з функцією Touch-Screen)

ПРОЕКТОРИ ЗНАКІВ

PACP-7000/PLC-7000

Специфікація

Таблиці	42EA
Проекційна відстань (м)	2.5-8м (6м для PLC-7000)
Збільшення таблиці	30 х (коли проектується з 5-ти метрів)
Лампа	LED
Швидкість зміни знаків	Середня швидкість - 0.21 сек. (Хв. 0.09 сек, макс. 0.32 сек)
Фільтр	Червоно/зелений
Програма	2 програми по 30 таблиць кожна
Джерело живлення	100-240 вольт ~, 50/60 герц
Габарити	202 х 364 х 172 мм

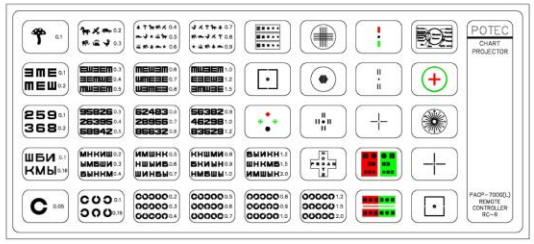

АВТОМАТИЧНИЙ РЕФРАКТО/КЕРАТОМЕТР

PRK-7000

Специфікація

РЕЖИМИ ВИМІРЮВАННЯ	
РЕЖИМ K/R	Поєднані Кератометрія та Рефрактометрія
РЕЖИМ REF	Рефрактометрія
РЕЖИМ KER	Кератометрія
РЕЖИМ CLBC	Режим вимірювання базової кривизни контактних лінз
РЕЖИМ K(P)	Периферійна кератометрія
РЕФРАКТОМЕТРІЯ	
Вертексна відстань(VD)	0.0, 12.0, 13.5, 15.0
Ось(SPH)	-25.00 ~ +22.00D (при VD=12мм) (з кроком: 0.12 і 0.25D)
Циліндр (CYL)	0.00 ~ ±10.00D (з кроком: 0.12 і 0.25D)
Ось (AX)	1 ~ 180° (з кроком : 1°)
Види циліндрів	-, +, MIX
Міжзінична відстань (PD)	10 ~ 88мм
Мінімальний діаметр зіниці	Ø2.0мм
КЕРАТОМЕТРІЯ	
Радіус кривизни	5.0 ~ 10.2мм (з кроком : 0.01мм)
Рогівкова рефракція	33.00 ~ 67.50 D (при еквівалентному показнику заломлення рогівки 1.3375) (з кроком: 0.05/0.12/0.25D)
Рогівковий астигматизм	0.00 ~ -15.00D (з кроком : 0.05/0.12/0.25D)
Ось	1 ~ 180° (з кроком : 1°)
ІНШІ	
Corneal Diameter	2.0 ~ 14.0мм (з кроком : 0.1мм)
Пам'ять даних	10 вимірювань на кожне око
Вбудований принтер	Стрічковий термопринтер з автовідрізом
Монітор	14.48см(5.7 дюйм) TFT-LCD з функцією Touch-Screen

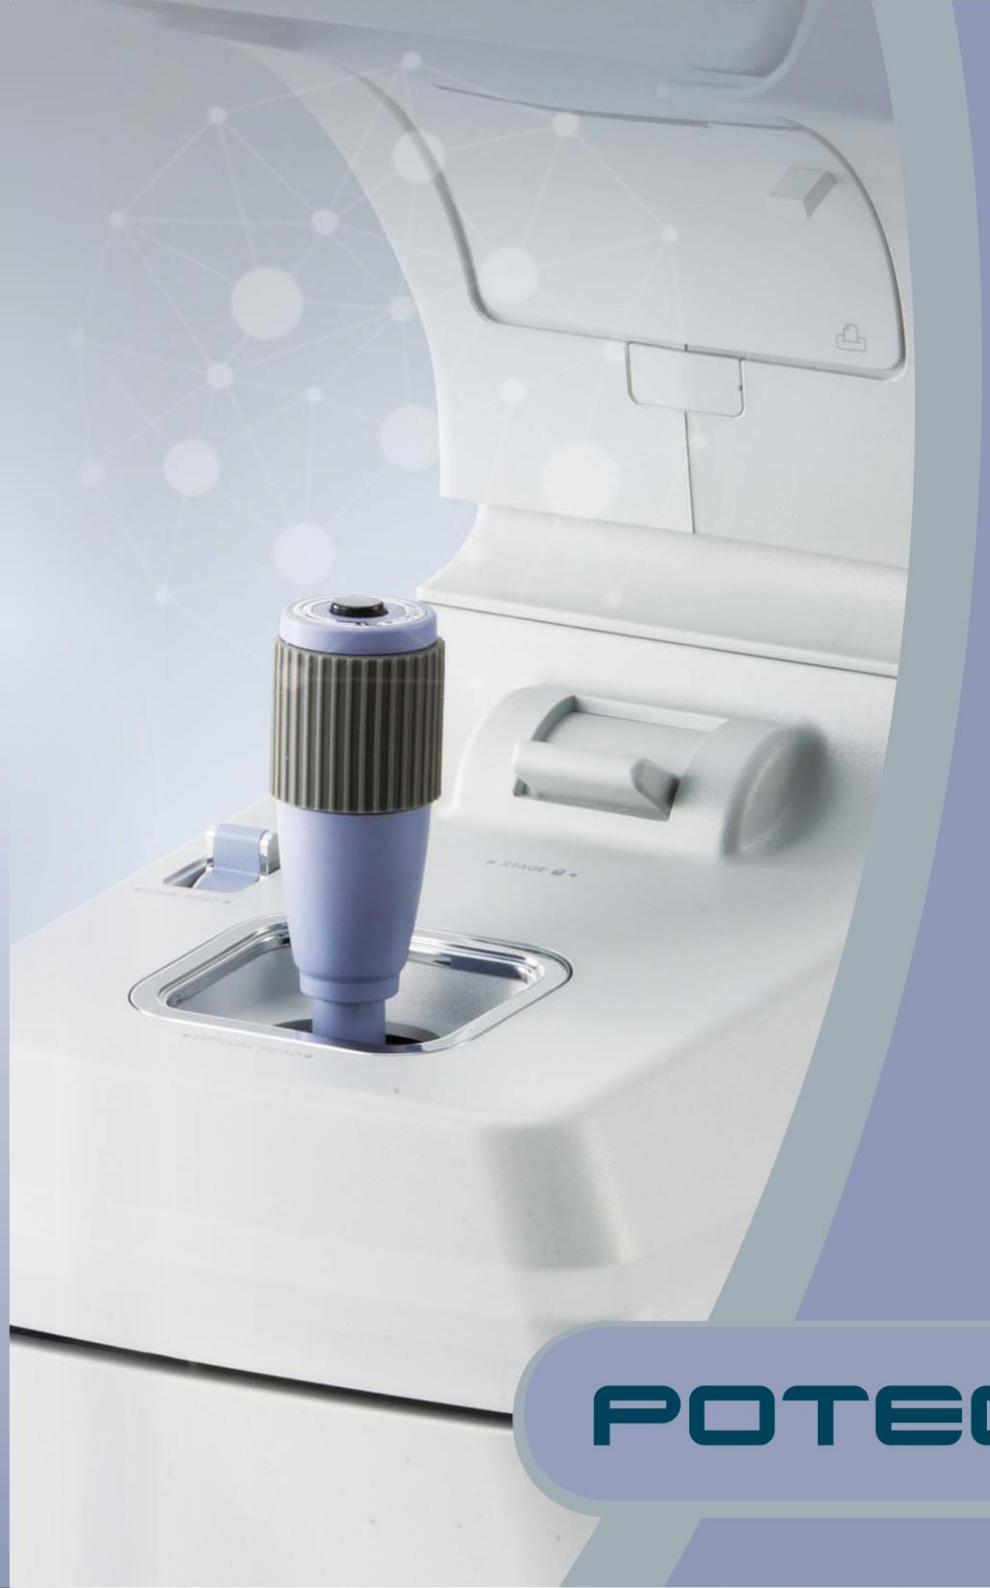

CE

POTEC

POTEC Co., Ltd.
40-4, Techno 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon
305-509, Korea
Tel +82 42 632 3536 / Fax +82 42 632 3537
webmaster@potec.biz www. potec. biz

Дистриб'ютор в Україні
ТОВ «АЙ ПІ МЕДІКАЛ»

Телефон: +38 057 732 68 70
e-mail: info@ipmedical.com.ua
www.ipmedical.com.ua

POTEC